Medisch diagnostisch apparaat

ACCUNIQ

BP850

Tweearmige bloeddrukmeter

's Werelds eerste automatische bloeddrukmeter welke twee armen meet. De gebruiksvriendelijke ACCUNIQ BP850 garandeert een snelle en betrouwbare bloeddruk meting.

ACCUNIQ

www.accuniq.nl

BP850 is ontworpen om betrouwbare en snelle resultaten te leveren. Deze zeer geavanceerde bloeddruk monitor is 's werelds eerste automatische bloeddruk meter welke twee armen meet voor een meer volledig resultaat.

Waarom moet de bloeddruk van beide armen worden gemeten?

Waarom moet de bloeddruk van beide armen worden gemeten?
Bloeddruk wordt meestal gemeten met de rechterarm. Als de systolische druk van de rechter- en linkerarm 15 mmHg of meer verschilt, hebben de aders naar uw ledematen de neiging nauwer te worden. Een dergelijke adervernauwing verhoogt naar verluidt het risico op een beroerte met 70% en het risico op overlijden door een gewone oorzaak met 60%.
Met de BP850 kunt u verschillen in bloeddruk tussen uw armen snel en gemakkelijk meten om eventuele verschillen in uw bloedsomloop in een vroeg stadium op te sporen.

Het toont de QR code op het LCD scherm. Als u het product koppelt aan een smartphone, slaat het uw bloeddrukgegevens op en helpt het u de trend bij te houden, zodat u uw bloeddruk onder controle houdt.

Resultaten weergave

1. Maximale bloeddruk in beide armen
2. Minimale bloeddruk
3. Gemiddelde bloeddruk
4. Verschil in bloeddruk
5. Polsslag

Diverse **resultaten bladen**

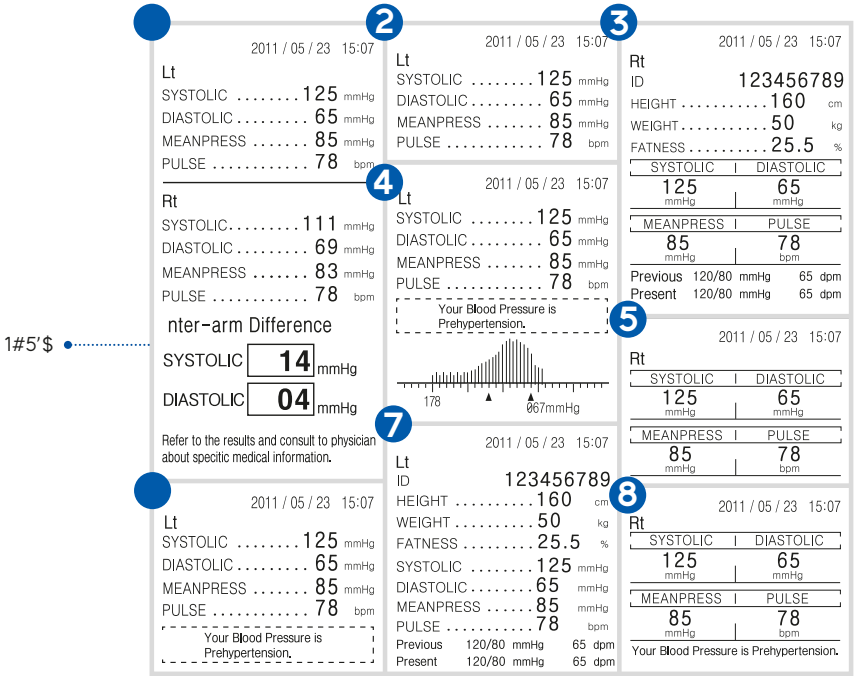

1. 7 inch LCD-kleurenscherm (touchscreen)
2. Gebruiksvriendelijke one-touch knop (hand- en voetschakelaar)
3. Snelle thermische printer met eenvoudige papiervervanging
4. Cuffs met een diameter van 150 mm om de gebruiker comfortabel te bedienen
5. Armsteunen en bewegingssensor op hetzelfde niveau om de analyse nauwkeuriger te maken

※ Volgens de aanbeveling van de WHO; wanneer de maximale bloeddruk van beide armen 20 mmHg verschilt, en de minimum bloeddruk 10 mmHg, kan dit wijzen op een risicofactor voor circulatieziekte, waarvoor medisch advies nodig is.

Hand- en voetschakelaar voor comfortabele metingen

Diverse opties

VIVIS Manager

A4 resultsatenblad

Verstelbare kruk

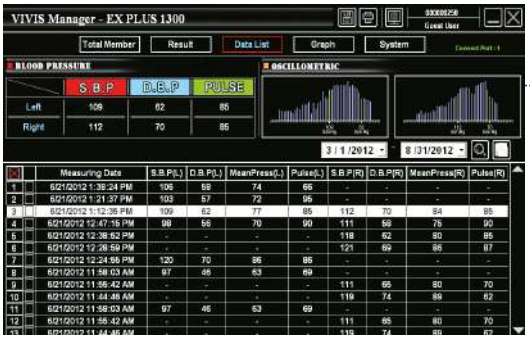

VIVIS Manager is een bloeddruk gegevens management programma dat u helpt bij het beheren van de analyse resultaten en cumulatieve gegevens.

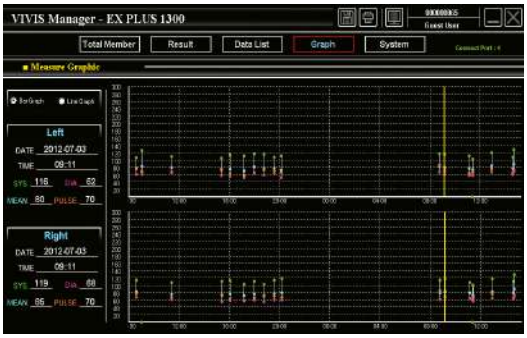

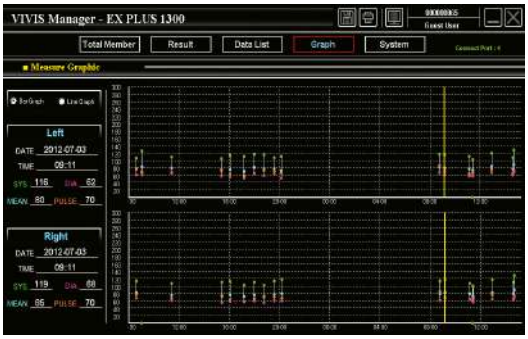

Drukloze Meetmethode

ACCUNIQ bloeddrukmeters meten de bloeddruk als de cuffs druk loos zijn.
Deze standaard meetmethode geeft resultaten die snel en nauwkeurig zijn.

ACCUNIQ's Depressurizing Measurement

VS

Upstream Pressurizing Measurement

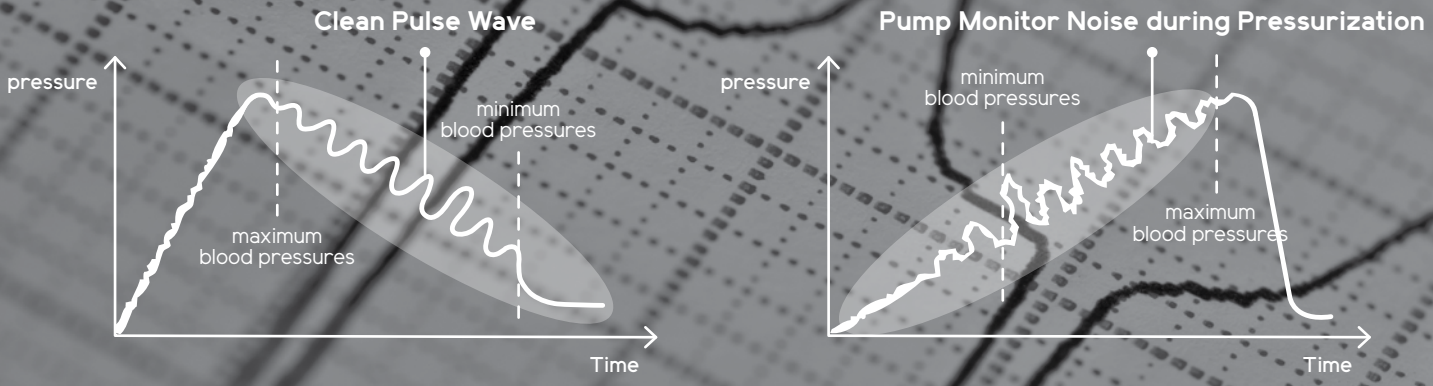

Risky Blood Pressure Level

Blood pressure classification by the US Combined Board JNC 7, 2003 (Unit: mmHg)

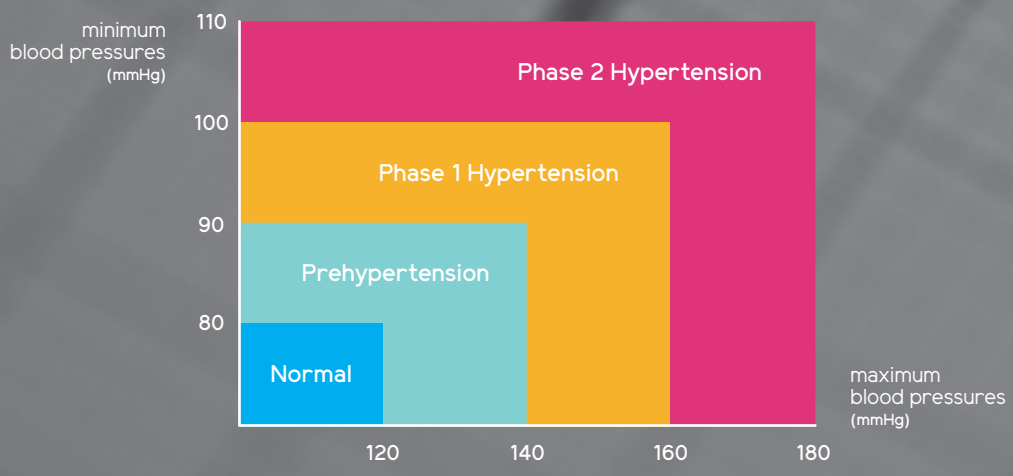

Diverse **analyse methodes**

Linker arm

Beide armen

Rechter arm

FAQ

Q. Wat kan ik doen als mijn bloeddruk sterk schommelt?

A. Ons lichaam ondergaat veranderingen en een constante circulatie. Bovendien varieert onze bloeddruk voortdurend op basis van onze hartslag en ademhalingsfrequentie. Aangezien onze bloeddruk niet precies kan worden bepaald door slechts één meting, wordt de laatste jaren steeds meer gebruik gemaakt van het 24 uur per dag bewakingssysteem. Om te bepalen of je manier van bloeddruk meten juist of onjuist is, kan je op onze website de voorzorgsmaatregelen bij het meten van de bloeddruk bekijken.

Q. Wat is DP (dubbel product)?

A. DP is je maximale bloeddruk vermenigvuldigd met polsslag. Hoe hoger je maximale bloeddruk en hoe sneller je polsslag, hoe hoger je DP is.

Q. Wat zijn de factoren die je bloeddruk veranderen?

A. Je bloeddruk kan veranderen gedurende 1 uur na een maaltijd, na het drinken van alcohol, koffie of thee (met cafeïne), na roken baden of lichaamsbeweging, als je spreekt of beweegt tijdens de analyse, wanneer de kamertemperatuur drastisch verandert, of nadat je bloeddrukverlagende medicijnen hebt ingenomen.

Q. Wat is het beste moment om mijn bloeddruk te meten?

A. Als je het 's morgens wilt doen, is het aan te bevelen dit te doen binnen 1 uur na het wakker worden, na het plassen en voor het ontbijt. Om het 's avonds te doen, is het het beste om te meten voordat je naar bed gaat. Het is ook aan te bevelen om het twee keer te doen - één keer 's morgens en één keer 's avonds op hetzelfde tijdstip.

ACCUNIQ BP850 Specificaties

Model	ACCUNIQ BP850
Meetmethode	Oscillometrisch
Display	7 inch LCD scherm
Plaats meting	Rechter arm/linker arm/beide armen
Meetbereik	Druk 30~300 mmHg, hartslag 30~200 slagen/minuut
Nauwkeurigheid	Druk: ±3 mmHg of binnen ±3%, hartslag binnen ±3%
Resolutie	1mmHg
Druk methode	DC Motor
Uitlaat methode	Micro-gestuurde elektronische lucht uitlaat
Drukopbouw tijd	Ongeveer 20 seconden per drukopbouw
Meet tijd	Ongeveer 50 seconden per meting
Data overbrenging	RS-232C, USB-kabel
Stroom	Ingang: AC100~240V, 50/60Hz, Uitgang: Gelijkstroom 12V, 5A adapter
Werkend bereik	Temperatuur : 10~40°C, Luchtvochtigheid: 30~75% (niet condenserend)
Afmeting	530 x 481 x 346 mm (L x B x H
Gewicht	12.0 kg
Af te lezen resultaten	Het meten van één arm: Systolische bloeddruk, Diastolische bloeddruk, Gemiddelde bloeddruk, Polsslag, Polsslagpatroon, Evaluatie van Bloeddruk Meten van beide armen: Systolische bloeddruk, Diastolische bloeddruk, Gemiddelde bloeddruk, Polsslag, Polsslagpatroon, Inter-arm drukverschil, Evaluatie van Bloeddruk
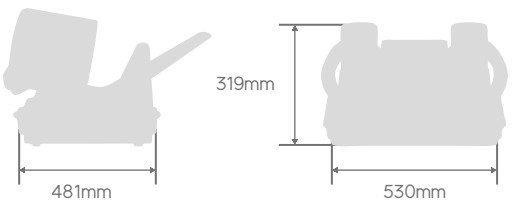
※Dit product is een 'medisch apparaat'.
Lees daarom zorgvuldig de 'voorzorgsmaatregelen voor gebruik' en 'hoe te gebruiken'.